

Uchazečům

č.j.: VZ 18/2015

Věc: Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky s názvem „CEITEC – centrifugy VFU“

Číslo veřejné zakázky: VZ 18/2015

Název veřejné zakázky: „CEITEC – centrifugy VFU“

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 01.06.2015 níže uvedenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedeným dotazům poskytuje ve lhůtě a v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatečnou informaci:

Dotaz uchazeče:

Vážení,

máme zájem podat nabídku k veřejné zakázce „CEITEC – centrifugy VFU“.

Máme však ještě společný dotaz k Zadávací dokumentaci – Technickým podmínkám pro část 1, konfiguraci 1 a pro část 2, konfiguraci 4:

Zadavatel požaduje ke stolní chlazené centrifuze úhlový rotor pro 15/50 ml zkumavky s požadovanou kapacitou 6 ks 50 ml zkumavek. K tomu požaduje dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 50 ml zkumavky alespoň 13 000xg a adaptéry pro 50 ml zkumavky s konickým dnem.

Centrifugy dosahující požadované minimální otáčky 14 000 RPM a minimální RCF 20 000xg mají obvykle s rotorem pro min. 6 x 50 ml zkumavky typu Falcon dosažitelné RCF pod 13 000 xg.

Žádáme zadavatele, aby zvážil možnost snížení požadované dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 50 ml zkumavky na alespoň 10 000 xg nebo zrušení požadavku na adaptéry pro 50 ml zkumavky s konickým dnem.


Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na splnění zadávacích podmínek. Zadavatel a koncový uživatel plánované aplikace vyžadují rotor s možností centrifugace biologického materiálu ve zkumavkách s kónickým dnem o objemu 50 ml při max. přetížení alespoň 13 000 g.

Zadávací dokumentace a podmínky v ní zůstávají nezměněny.

V Brně dne: 4. 6. 2015

VFU Brno
zastoupená prof. MVDr. Jiřím Smolou, CSc.,
ředitelem CEITEC VFU Brno

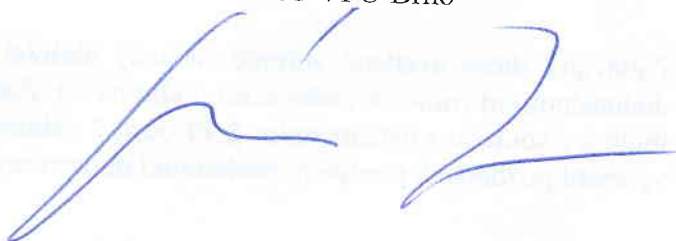

Vyřizuje: Mgr. Jiří Sobotka
sobotkaj@vfu.cz, 541562057